

ZP/UR/120/2012

Załącznik nr 1a do SIWZ

Z M O D Y F I K O W A N Y

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(usunięcie pozycji K nr 34 - rękawiczki)

CZEŚĆ 1: dostawa zestawu urządzeń do budowy SYSTEMU PROCESORA OPTYCZNEGO oraz SYSTEMU HOLOGRAFICZNEGO ZAPISU INFORMACJI do Pracowni Optycznych Metod Przetwarzania Informacji w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Przyrodniczo-Technicznej

A. Stół optyczny z aktywnym systemem izolacji drgań z zestawem izolatorów i kompresorem

- Wielkość płaszczyzny roboczej stołu: nie mniejsza niż 1,5×3,0m,
- Trójwarstwowa konstrukcja blatu stołu typu honeycomb o grubości nie mniejszej niż 0,3 m,
- Górna powierzchnia blatu stołu wykonana ze stali ferromagnetycznej,
- Otwory montażowe o rozmiarze M6, tworzące siatkę o stałej 25 mm,
- Otwory zaślepienie od spodu pod powierzchnią blatu (zabezpieczenie przed wpadaniem małych przedmiotów),
- Nierówności płaszczyzny stołu nie większe niż 0,1mm na m²,
- System monitorowania (przesyłanie danych do komputera) i aktywnego tłumienia drgań wywołanych przez urządzenia zamontowane na stole,
- Samopoziomujący system pneumatycznych izolatorów (podpór),
- Wysokość blatu stołu: od 88 do 92 cm,
- Kompresor powietrza z filtrem powietrza, o niskiej emisji drgań i dźwięku, o wydajności pozwalającej na zasilanie 3 stołów optycznych,
- Możliwość pracy stołu bez konieczności ciągłego pompowania systemu tłumienia drgań

Cena zawierać powinna koszty transportu, montażu we wskazanym pomieszczeniu laboratoryjnym i przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń.

Gwarancja co najmniej 2 lata.

B. Stół optyczny z aktywnym systemem izolacji drgań z zestawem izolatorów i kompresorem

- Powierzchnia robocza o wymiarach nie mniejszych niż 1,5×7,5 m. Powinna się ona składać z co najmniej dwóch blatów łączonych wzdłuż krótszej z krawędzi,
- Trójwarstwowa konstrukcja blatu stołu typu honeycomb o grubości nie mniejszej niż 0,3 m,
- Górna powierzchnia blatu stołu wykonana ze stali ferromagnetycznej,
- Otwory montażowe o rozmiarze M6, tworzące siatkę o stałej 25 mm,
- Otwory zaślepienie od spodu pod powierzchnią blatu (zabezpieczenie przed wpadaniem małych przedmiotów),
- Nierówności płaszczyzny stołu nie większe niż 0,1mm na m²,
- Samopoziomujący system pneumatycznych izolatorów,
- Liczba izolatorów powinna pozwalać na wykorzystanie obu blatów po ich ewentualnym rozłączeniu (8 szt.),
- Wysokość blatu stołu: od 88 do 92 cm,
- Kompresor powietrza z filtrem powietrza, o niskiej emisji drgań i dźwięku, o wydajności pozwalającej na zasilanie 3 stołów optycznych,
- Możliwość pracy stołu bez konieczności ciągłego pompowania systemu tłumienia drgań.

Cena zawierać powinna koszty transportu, montażu we wskazanym pomieszczeniu laboratoryjnym i przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń.

Gwarancja co najmniej 2 lata.

C. Laser pracy ciągłej (światło o brawie zielonej)

- o Długość fali: 532 ± 1 nm (światło o brawie zielonej),
- o Mod pracy: TEM₀₀,
- o Jakość wiązki $M^2 < 1.1$,
- o Stabilność kierunku wiązki $< 6 \mu\text{rad}/^\circ\text{C}$
- o Szerokość spektralna: $< 0,01$ pm,
- o Moc: nie mniej niż 200 mW,
- o Współczynnik polaryzacji: $>100:1$, liniowa,
- o Podstawa umożliwiająca zamontowanie głowicy lasera na stole optycznym tak, aby wiązka lasera znajdowała się na wysokości osi optycznej pozostałych podzespołów i pozwalała na regulację w zakresie co najmniej ± 2 cm,

Cena zawierać powinna koszty transportu, montażu i przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń,

Gwarancja co najmniej 2 lata.

D. Układ laserowy pracy ciągłej emitujący jednocześnie fale o dwóch długościach (światło barwy czerwonej oraz niebieskiej)

- o Długość fali z zakresu: 632- 650 nm (światło o brawie czerwonej) oraz 487-489 nm (światło o brawie niebieskiej),
- o Mod pracy: TEM₀₀,
- o Jakość wiązki $M^2 < 1.2$,
- o Stabilność kierunku wiązki $< 6 \mu\text{rad}/^\circ\text{C}$
- o Szerokość spektralna: < 0.01 pm,
- o Moc: nie mniej niż 100 mW dla każdej długości fali,
- o Współczynnik polaryzacji: $>100:1$, liniowa,
- o Podstawa umożliwiająca zamontowanie głowicy układu laserowego na stole optycznym tak, aby wiązka lasera znajdowała się na wysokości osi optycznej pozostałych podzespołów, oraz regulację wysokości osi optycznej w zakresie co najmniej ± 2 cm.

Cena zawierać powinna koszty transportu, montażu i przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń.

Gwarancja co najmniej 2 lata.

E. Laser impulsowy ze zwierciadłem dichroicznym i postumentem

- o Praca w trybie generacji dwóch impulsów z regulowanym odstępem pomiędzy impulsami, uzyskana przez głowicę lasera zawierającą 2 oscylatory w jednej obudowie, układ łączenia torów optycznych, separacyjną optykę dichroiczną oraz generator harmonicznych,
- o Długość fali: 532 nm (światło barwy zielonej),
- o Laser musi posiadać posiew długości fali (z ang. "Injection seeder"), który modyfikuje parametry wiązki w następujący sposób (dodatkowy laser zwany „seeder'em”):
 - Szerokość pasma $< 0.005 \text{ cm}^{-1}$ dla 532nm,
 - Droga koherencji > 1 m dla 532nm,
 - Maksymalny spadek energii impulsu $< 15\%$,
 - Laser posiewający musi „seed’ować” jednocześnie oba oscylatory laserowe, by oba wyjścia miały identyczną długość fali,
 - Laser posiewający musi „seed’ować” układ poza osią optyczną oscylatora, by zapobiec ryzyku zniszczenia lasera w wyniku zwrotnego odbicia impulsu,
- o Energia w impulsie: nie mniej niż 280 mJ dla 532nm (maksymalny spadek energii impulsu wynikający z „scedowania” to 15%),
- o Czas trwania impulsu: 5-8ns,
- o Odstęp pomiędzy impulsami: od < 100 ns do 100ms (regulowany). System musi być wyposażony w 4-kanalowy generator impulsów z opóźnieniem o parametrach nie gorszych niż model DG535 firmy Stanford Research Systems,
- o Średnia stabilność kierunku powiązanych wiązek $< \pm 100 \mu\text{rad}$ przez okres 8 godzin dla zmian temperatury, ± 3 °C (mierzone po rozgrzaniu lasera),
- o Rozbieżność wiązki (pełen kąt) < 0.5 mrad mierzony w punktach FWHM,
- o Czas życia lamp > 30 mln impulsów,
- o Laser musi posiadać możliwość pracy w trybie długiego impulsu (około 200 mikrosekund) potrzebnego do bezpiecznego strojenia optyki za laserem,

- Ścieżka optyczna zabezpieczona przed wpływem kurzu,
- Wnęki rezonansowe pozwalające na łatwe usunięcie ewentualnych zabrudzeń (pokryte złotem) oraz zapewniające jednorodne oświetlenie ośrodka aktywnego i eliminujące wszelakie „gorące punkty”, które mogą powodować zniszczenia optyki i detektorów CCD za laserem,
- Wymiana lamp we wnęce rezonansowej nie może wymagać wyciągnięcia całej wnęki rezonansowej z lasera (co powoduje utratę strojenia wszystkich elementów optycznych lasera),
- Wmontowane wewnątrz lasera zwierciadło dichroiczne dla 532nm,
- Interfejs umożliwiający sterowanie za pomocą komputera,
- Podstawa umożliwiająca zamontowanie na oferowanych stołach optycznych,
- Dedykowany system chłodzenia,
- Dedykowany jeden zasilacz dla lasera w zestawie o wymaganiach <25A dla 190-260 V, jedna faza, 50/60 Hz. Połączenie głowicy z zasilaczem jest zapewnione przez co najmniej 3 metrowy przewód.

Cena zawierać powinna koszty transportu, montażu i przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń.

Gwarancja co najmniej 2 lata.

F. 3 zestawy przestrzennych modulatorów światła (SLM) każdy w składzie:

- a. Przestrzenny modulator fazy fali świetlnej**
- b. Przestrzenny modulator amplitudy fali świetlnej**

Wymagania dla modulatorów światła (wspólne dla obu typów)

- Tryb pracy: odbiciowy,
- Liczba pikseli: nie mniej niż 1920 x 1080,
- Rozmiar piksela: nie większy niż 9 μm ,
- Liczba poziomów kwantyzacji: co najmniej 8 bitów,
- Interfejs umożliwiający sterowanie za pomocą komputera przez port DVI,
- Warstwa antyodbiciowa w zakresie widzialnym fal elektromagnetycznych,
- Sterownik działający w systemie Windows oraz podstawowe oprogramowanie,
- Uchwyt modulatora z regulacją wysokości umożliwiający montaż na stole optycznym z otworami M6.

Modulatory powinny zostać dostarczone razem z układem sterującym w skład którego powinno wchodzić dwa kontrolery, z których każdy powinien pozwalać na podłączenie trzech modulatorów tego samego typu oraz na ich synchronizację. Sterowanie powinno odbywać się za pomocą dwóch przenośnych urządzeń, z których każde wyposażone powinno być w: procesor osiągający w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 8 900 punktów PassMark - CPU Mark (Wynik proponowanego procesora musi znajdować się na stronie <http://www.cpubenchmark.net> - wynik na dzień 27.08.2012); matową matrycę o przekątnej 15.5"-16" i rozdzielczości 1366 x 768; dysk twardy: 500 GB lub większy Serial ATA; pamięć RAM: 8 GB DDR3 (1066 MHz), dedykowaną kartę graficzną z co najmniej 1024 MB własnej pamięci wspierającą DirectX11; napęd optyczny: Blu-ray (BD-Drive); interfejsy, co najmniej: HDMI, DVI, RS 232, 3 x USB 2.0, 1x USB 3.0, czytnik kart pamięci, WiFi IEEE 802.11b/g/n, LAN 1 Gbps, Bluetooth 2.1 + EDR; oraz niezbędne; Kontrola pracy powinna odbywać się w dołączonym systemie Windows.

Cena zawierać powinna koszty transportu, montażu i przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń.

Gwarancja co najmniej 2 lata.

G. Kamera laboratoryjna

- Rodzaj detektora: monochromatyczny, CCD,
- Liczba pikseli w matrycy: nie mniej niż 4 miliony pikseli,
- Rozmiar piksela: nie większy niż 10 μm (kwadratowe),
- Wydajność kwantowa dla 532 nm: powyżej 50%,
- Migawka: elektroniczna,
- Wyzwalanie: zewnętrzne,
- Budowa zapobiegająca interferencjom na elementach kamery,
- Powinna współpracować z laserem dwimpulsowym wyspecyfikowanym w punkcie C, pozwalając na rejestrację 2 obrazów w pełnej rozdzielczości co <100ns,

- o Możliwość podłączenia do komputera z systemem Windows (w zestawie odpowiednia karta rozszerzeń do komputera, jeśli wymagana),
- o Oprogramowanie do akwizycji i wstępnej analizy obrazów,
- o Obiektów stało-ogniskowy o ogniskowej 50mm,
- o Uchwyt o regulowanej wysokości pozwalający na ustawienie kamery w osi optycznej układu. Montaż na stole optycznym z otworami M6.

Cena zawierać powinna koszty transportu, montażu i przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń.

Gwarancja co najmniej 2 lata.

H. Piezoelektryczny przesuwnik zwierciadła

- o Możliwość ruchu zwierciadła w kierunku prostopadłym do płaszczyzny jego zamontowania,
- o Dokładność przesuwu: co najmniej 3 nm,
- o Zakres przesuwu: co najmniej 3 μm ,
- o Wmontowany czujnik położenia zwierciadła,
- o Możliwość zamontowania uchwytu zwierciadła prostopadle do płaszczyzny stołu,
- o Dedykowany kontroler sprzętowy z możliwością sterowania za pomocą komputera.

Cena zawierać powinna koszty transportu, montażu i przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń.

Gwarancja co najmniej 2 lata.

I. Zestaw zmotoryzowanych przesuwników (aktuatorów) do elementów optomechanicznych (24 szt.) wraz z sterownikami tych elementów (3 szt.)

Wymagania odnośnie aktuatorów

- o Mocowanie umożliwiające zamontowanie do wszystkich oferowanych urządzeń optomechanicznych.
- o Dokładność przesuwu: 0,2 μm ,
- o Maksymalne wychylenie dostosowane do oferowanych uchwytów optomechanicznych, ograniczane za pomocą oprogramowania.

Wymagania odnośnie sterownika aktuatorów

- o Urządzenie umożliwiające jednoczesne sterowanie co najmniej ośmioma oferowanymi aktuatorami,
- o Sterownik powinien mieć możliwość podłączenia do komputera oraz oprogramowanie dla pracy w środowisku LabView.

Cena zawierać powinna koszty transportu, montażu i przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń,

Gwarancja co najmniej 2 lata.

J. Miernik mocy i energii wiązki lasera z głowicami dla laserów pracy ciągłej i impulsowej

Miernik mocy i energii wiązki lasera

- o Częstotliwość próbkowania min. 100 kHz,
- o Czułość 2.5 μA – 25 mA; 2.5 mV – 130 V,
- o Możliwość współpracy ze źródłem o częstotliwości pracy 4 kHz przy zastosowaniu detektora diodowego i 2 kHz przy standardowym detektorze piroelektrycznym,
- o Zakres pomiarów mocy lasera (detektor fotodiodowy) 1 nW – 40 W,
- o Zakres pomiarów energii lasera (detektor piroelektryczny) 100 μJ – 75 J,
- o Rozdzielczość: min. 10 pA, min. 70 nV,
- o Stosunek sygnału do szumu około 100 dB,
- o Pasma DC (-3 dB): 500 kHz (detektor fotodiodowy); 1 MHz (detektor piroelektryczny),
- o Pamięć wewnętrzna na min. 250 tys. punktów,
- o Możliwość podłączenia zewnętrznej pamięci USB,
- o Kolorowy wyświetlacz graficzny,
- o Dokładność pomiarowa (Pulse-to-Pulse i Peak-to-Peak) co najmniej $\pm 1\%$,
- o Interfejs USB,
- o Dołączone oprogramowanie do prostej analizy graficznej, matematycznej i statystycznej.

Współpracująca z oferowanym miernikiem głowica do pomiaru mocy oferowanych laserów pracy ciągłej.

Współpracująca z oferowanym miernikiem głowica do pomiaru energii oferowanych laserów pracy impulsowej.

Cena zawierać powinna koszty transportu, montażu i przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń.


Gwarancja co najmniej 2 lata.

K. Urządzenia optyczne i optomechaniczne

- Urządzenia optomechaniczne powinny być kompatybilne ze sobą nawzajem. Jeśli nie będą pochodziły one od jednego producenta, oferent powinien zagwarantować ich pełną kompatybilność z pozostałymi urządzeniami (montaż na stole, wymienne aktuatory, możliwość ustalenia takiej samej wysokości osi optycznej we wszystkich urządzeniach).
 - Wszystkie urządzenia optomechaniczne wykonane ze stali pozbawionej efektu rozszerzalności termicznej,
 - Wszystkie urządzenia optomechaniczne powinny być wyposażone w stabilne posty, pozwalające na ustawienie osi optycznych zamontowanych urządzeń optycznych na jednej wysokości oraz uchwyty i śrubki niezbędne do ich montażu na stole optycznym.
 - Wszystkie elementy optyczne powinny być zoptymalizowane dla zakresu długości fal i mocy proponowanych urządzeń laserowych.
 - Wymiary wszystkich elementów optycznych powinny umożliwiać ich precyzyjny montaż w oferowanych uchwytach optomechanicznych.
1. Zestaw 8 zwierciadeł o średnicy około 25 mm dostosowane do mocowania w oferowanych uchwytach zwierciadeł. Nieregularności powierzchni zwierciadeł nie większe niż $\lambda/10$.
 2. Zestaw 12 zwierciadeł o średnicy nie mniejszej niż 50 mm dostosowane do mocowania w oferowanych uchwytach zwierciadeł. Nieregularności powierzchni zwierciadeł nie większe niż $\lambda/10$.
 3. Zestaw 3 zwierciadeł o średnicy około 76 mm dostosowane do mocowania w oferowanych uchwytach zwierciadeł. Nieregularności powierzchni zwierciadeł nie większe niż $\lambda/10$.
 4. Zestaw 4 uchwytów zwierciadeł o średnicy około 25 mm wraz postami. Uchwyty powinny pozwalać na regulację kierunku odbicia wiązki za pomocą aktuatorów. Osie obrotu powinny przebiegać prostopadle do siebie a stycznie do krawędzi zamontowanego zwierciadła.
 5. Zestaw 4 uchwytów zwierciadeł o średnicy około 25 mm wraz postami. Uchwyty powinny pozwalać na regulację kierunku odbicia wiązki za pomocą aktuatorów. Osie obrotu powinny przebiegać prostopadle do siebie przez środek żrenicy zwierciadła.
 6. Zestaw 4 uchwytów zwierciadeł o średnicy około 50 mm wraz postami. Uchwyty powinny pozwalać na regulację kierunku odbicia wiązki za pomocą aktuatorów. Osie obrotu powinny przebiegać prostopadle do siebie a stycznie do krawędzi zamontowanego zwierciadła.
 7. Zestaw 6 uchwytów zwierciadeł o średnicy około 50 mm wraz postami. Uchwyty powinny pozwalać na regulację kierunku odbicia wiązki za pomocą aktuatorów. Osie obrotu powinny przebiegać prostopadle do siebie przez środek żrenicy zwierciadła.
 8. Zestaw 2 uchwytów zwierciadeł o średnicy około 76 mm wraz postami. Uchwyty powinny pozwalać na regulację kierunku odbicia wiązki za pomocą aktuatorów. Osie obrotu powinny przebiegać prostopadle do siebie a stycznie do krawędzi zamontowanego zwierciadła.
 9. Zestaw 9 sześciennych kostek światłdzielących, o boku nie krótszym niż 50 mm. Kostki powinny dzielić wiązkę światła na dwie o jednakowych gęstościach mocy i tej samej polaryzacji. Powinny posiadać warstwę antyodblaskową, dzięki której transmitancja światła generowanego przez wszystkie z oferowanych laserów jest nie mniejsza niż 90%.
 10. Zestaw 2 sześciennych kostek światłdzielących, o boku około 25 mm. Kostki powinny dzielić wiązkę światła na dwie o jednakowych gęstościach mocy i tej samej polaryzacji. Powinny posiadać warstwę antyodblaskową, dzięki której transmitancja światła generowanego przez wszystkie z oferowanych laserów jest nie mniejsza niż 90%.
 11. Zestaw 3 dzielników wiązki z płynnie regulowanym, za pomocą pokrętki, podziałem mocy (0 - 90 % mocy w jednej wiązce). Rozdzielone wiązki powinny mieć pionową polaryzację. Urządzenia powinny być dostosowane do długości fal proponowanych laserów pracy ciągłej (po jednym dzielniku dla każdego z 3 laserów pracy ciągłej z obu zadań). Średnice wejściowe i wyjściowe wiązek nie mniejsze niż 5 mm, a straty mocy nie większe niż 2%. Układ powinien

być montowalny na stoliku pozwalającym na przesuwanie i obrót w płaszczyźnie stołu optycznego.

12. Zestaw 12 stolików obrotowych do stabilnego montażu (uchwyt) sześciennych kostek światłodzielnycych o boku nie krótszym niż 50 mm, dających możliwość stabilnego montażu oraz obrotu w zakresie do 0,5° i przesunięcia w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach leżących w płaszczyźnie montażu na stole optycznym. Regulacja położenia odbywać powinna się za pomocą dedykowanych aktuatorów. Układ powinien być montowalny na takiej samej wysokości jak pozostałe elementy optomechaniczne. Powierzchnia robocza stolików powinna pozwolić na stabilny montaż wszystkich elementów optycznych (modulator światła: punkt F; kostka światłodzielnycza: punkt K.9; soczewki o średnicy około 50 mm: punkt K.13;) wraz z uchwytami optomechanicznymi (uchwyty soczewek: punkt K.16; dedykowany uchwyt modulatora światła; uchwyt kostki światłodzielnyczej) w konfiguracji przedstawionej na rysunku 1. Długość boku kostki światłodzielnyczej wynosi około 50mm. Średnica soczewki około 50 mm.

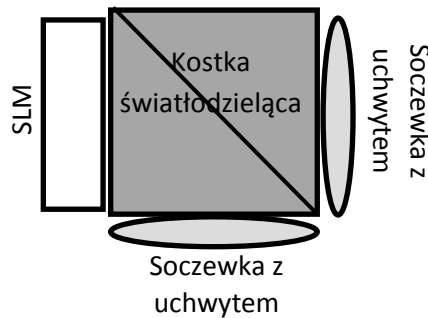

Rysunek 1. Konfiguracja montażu układu przestrzennego modulatora światła (SLM) wraz z kostką światłodzielnyczą i dwiema soczewkami - widok od góry.

13. Zestaw soczewek składający się z:
 - a. Co najmniej 85 soczewek różnych typów (płasko-wypukłe, dwuwypukłe, płasko-wklęsłe, wklęsło-wklęsłe) o średnicy około 25 mm, ogniskowych z zakresu od około 20 do 1000 mm dla soczewek skupiających i -25 do -200 mm dla soczewek rozpraszających, przy czym każda z soczewek powinna występować w dwóch egzemplarzach.
 - b. Co najmniej 80 soczewek różnych typów (płasko-wypukłe, dwuwypukłe, płasko-wklęsłe, wklęsło-wklęsłe) o średnicy około 50 mm, ogniskowych z zakresu od około 40 do 1000 mm dla soczewek skupiających i -75 do -500 mm dla soczewek rozpraszających, przy czym każda z soczewek powinna występować w dwóch egzemplarzach.
 - c. 32 soczewek dwuwypukłych o średnicy co najmniej 50 mm, różniących się wartością ogniskowych w zakresie od 10 do 1000 mm, gdzie każda z soczewek powinna występować w 4 egzemplarzach.Wszystkie soczewki powinny posiadać z warstwą antyodblaskową optymalizowaną dla fal z zakresu 430-700 nm i zapewniającą transmisję nie mniejszą niż 99%. Nieregularności powierzchni nie powinny być większej niż $\lambda/4$. Zestaw powinien być zapakowany w skrzynkę (skrzynki) zapobiegające uszkodzeniu soczewek.
14. Zestaw 4 dubletów soczewek achromatycznych o ogniskowej 750 mm. Wszystkie dublety soczewek achromatycznych powinny posiadać z warstwą antyodblaskową optymalizowaną dla fal z zakresu 430-700 nm i zapewniającą transmisję nie mniejszą niż 99%. Nieregularności powierzchni nie powinny być większej niż $\lambda/4$. Zestaw powinien być zapakowany w skrzynkę zapobiegające uszkodzeniu soczewek.
15. 8 uchwytów soczewek dostosowanych średnicą do oferowanych soczewek o średnicy około 50 mm (oraz po zastosowaniu redukcji średnicy gniazda soczewki do około 25 mm), umożliwiające regulację ich położenia w płaszczyźnie prostopadłej do osi optycznej, oraz wzdłuż osi optycznej.
16. Zestaw 6 uchwytów soczewek, pozwalających na zamontowanie soczewek o obu średnicach, umożliwiających regulację ich położenia w płaszczyźnie prostopadłej do osi optycznej. Uchwyty powinny pozwalać na taki montaż, aby powierzchnie przestrzennego modulatora światła i soczewek znajdowały się w bliskim sąsiedztwie kostki światłodzielnyczej w konfiguracji przedstawionej na rysunku 1.
17. Zestaw 3 ekspanderów wiązki (z uchwytami), na wyjściu których wiązka powinna być odfiltrowaną przestrzennie falą płaską o średnicy w zakresie 40-50 mm.

18. Ekspander wiązki (z uchwytem), o średnicy wejściowej wiązki około 1mm na wyjściu którego wiązka powinna być odfiltrowaną przestrzenią falą płaską o średnicy około 3 mm.
19. Zestaw 2 zoptymalizowanych dla promieniowania widzialnego kolimatorów wiązki (z uchwytami), na wyjściu których wiązka powinna być falą płaską o średnicy około 20 mm, przy jej średnicy wejściowej około 2 mm.
20. Zestaw 3 przesłon irysowych z regulacją średnicy źrenicy w zakresie od 1,5 do 40 mm i sterowaną za pomocą komputera funkcją migawki elektronicznej, przy czym czas odpowiedzi nie powinien przekraczać 80 μ s.
21. Zestaw 3 przesłon szczelinowych umożliwiających regulację ich szerokości za pomocą śruby mikrometrycznej w zakresie 0-5mm. Możliwość montażu urządzenia tak aby szczelina mogła mieć orientację pionową lub poziomą. Długość szczeliny nie powinna być mniejsza niż 12 mm.
22. Zestaw 2 filtrów przestrzennych umożliwiających montaż oferowanych obiektywów mikroskopowych i pinholi oraz regulację ich względnego położenia (XYZ) za pomocą śrub mikrometrycznych,
23. 2 standardowe zestawy pinholi.
24. 4 standardowe zestawy obiektywów mikroskopowych.
25. Zestaw 4 uchwytów obiektywu mikroskopowego bez regulacji jego położenia,
26. 4 zestawy polaryzatorów liniowych z uchwytami obracalnymi,
27. 2 standardowe zestawy filtrów szarych o transmitancjach z zakresu od około 0.1 do 4.0,
28. Zestaw 8 półfalówek o średnicy około 25 mm, zoptymalizowanych dla długości fal światła generowanych przez oferowane lasery (4 dla światła zielonego, po dwie dla światła niebieskiego i czerwonego),
29. Zestaw 6 ćwierćfalówek o średnicy około 25 mm, po 2 dla każdej z długości fal światła generowanych przez oferowane lasery,
30. Zestaw 6 matówek o różnych chropowatościach i średnicy pozwalającej na montaż w uchwytach soczewek (około 25 mm).
31. Zestaw 4 uchwytów na oferowane ćwierćfalówki i półfalówki,
32. Zestaw 3 stolików z regulowaną w zakresie od około 25 do 45 mm wysokością położenia blatu,
33. Zestaw 9 okularów ochronnych o trwałych oprawkach, po 3 sztuki dla każdej długości fali światła oferowanych laserów.

Cena zawierać powinna koszty transportu, montażu i przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń.

Gwarancja co najmniej 2 lata.

L. Jednostka sterująca urządzeniami optomechanicznymi (komputer PC)

- o Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 10 380 punktów PassMark - CPU Mark (Wynik proponowanego procesora musi znajdować się na stronie <http://www.cpubenchmark.net> - wynik na dzień 27.08.2012). W przypadku użycia przez Wnioskodawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego,
- o Pamięć RAM co najmniej 16GB DDR3 taktowana co najmniej 1600 MHz,
- o Płyta główna posiadająca 2 gniazda PCI Express, gniazda RS232, USB 2.0 i 3.0 (co najmniej 10 sztuk), FireWire (IEEE 1394). Technologia vPro. Cichy system chłodzenia.
- o Karta sieciowa Gigabit Ethernet o maksymalnej przepustowości 1Gb/s,
- o Komputer powinien posiadać kartę sieciową Wi-fi co najmniej 802.11g Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz,
- o Karta graficzna posiadająca min 1024 MB pamięci o szerokości magistrali co najmniej 128 bitów obsługująca technologię CUDA posiadające wyjście DVI, wyjście VGA, oraz HDMI.
- o Dysk systemowy SSD o pojemności co najmniej 250GB,
- o Dysk twardy SATA min 2 TB, 7200 obr./min., 64MB pamięci podręcznej,
- o Nagrywarka DVD-RW,
- o Monitor LCD z matrycą typu IPS lub PVA, podświetlenie bezpośrednie, przekątna 22 - 24", rozdzielczość 1920 x 1080 lub wyższa, matowa matryca, kontrast statyczny co najmniej 1000:1, wejścia sygnału HDMI lub DVI, możliwość zmiany orientacji zamontowania monitora (pozioma, pionowa),
- o Obudowa: obsługiwane płyty główne Micro-ATX/ ATX typu midi-tower z matami wygłuszającymi,

- Zasilacz legitymujący się mocą pokrywającą w co najmniej 120% zapotrzebowanie komponentów, z dodatkową stabilizacją napięcia; filtrami: przeciw-przeciążeniowym, przeciw-przebiegiowym, przeciwzwarciovym z zabezpieczeniem termicznym, głośność poniżej 16 dB,
- Bezprzewodowa mysz laserowa USB,
- Klawiatura USB z klawiszami o niskim skoku,
- Zestaw głośników 2.1,
- Zestaw powinien zawierać dodatkowo UPS pozwalający na podtrzymanie zasilania komputera co najmniej przez 7 minut, przy mocy wyjściowej powyżej 750 W, niezbędne kable (podłączenie UPS do sieci oraz kable do poszczególnych komputerów).
- Zestaw powinien zawierać wszelkie kable do podłączenia urządzeń peryferyjnych, przewody zasilające oraz 4 przejściówki USB-RS232.
- Z komputerem powinny zostać dostarczone sterowniki, system operacyjny Windows, oraz pakiet biurowy Microsoft Office w aktualnych wersjach, oraz program LabView w wersji Academic Premium Suite,
- Listwa zasilająca na 5 gniazd,
- Gwarancja co najmniej 2 lata.

M. Jednostka sterująca modulatorami światła (komputer PC)

- Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 10 380 punktów PassMark - CPU Mark (Wynik proponowanego procesora musi znajdować się na stronie <http://www.cpubenchmark.net> - wynik na dzień 27.08.2012). W przypadku użycia przez Wnioskodawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego,
- Pamięć RAM: co najmniej 16 GB DDR3 taktowana co najmniej 1600 MHz,
- Płyta główna posiadająca 2 gniazda PCI Express, gniazdo RS232, USB 2.0 i 3.0 (co najmniej 10), FireWire (IEEE 1394). Technologia vPro. Cichy system chłodzenia.
- Karta sieciowa Gigabit Ethernet o przepustowości co najmniej 1Gb/s,
- Komputer powinien posiadać kartę sieciową Wi-fi co najmniej 802.11g Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz,
- Karta graficzna posiadająca min 2048 MB pamięci, magistralę co najmniej 256 bitów, wyjście VGA, HDMI, co najmniej 3 gniazda DVI oraz obsługująca technologię CUDA,
- Dysk systemowy SSD o pojemności co najmniej 250 GB,
- Dysk HDD SATA min 2 TB, 7200 obr./min., 64MB pamięci podręcznej,
- Nagrywarka Blue-Ray, szybkość zapisu BD-R co najmniej 12x,
- Monitor LCD z matrycą typu IPS lub PVA, podświetlenie bezpośrednie, przekątna 22-24", rozdzielczość 1920 x 1080 lub wyższa, matowa matryca, kontrast statyczny co najmniej 1000:1, wejścia sygnału HDMI lub DVI, możliwość zmiany orientacji zamontowania monitora (tryb pejzażowy i portretowy),
- Obudowa: obsługiwane płyty główne Micro-ATX/ ATX typu midi-tower z matami wygłuszającymi,
- Zasilacz legitymujący się mocą pokrywającą w 120% zapotrzebowanie komponentów, z dodatkową stabilizacją napięcia; filtrami: przeciw-przeciążeniowym, przeciwprzebiegiowym, przeciwzwarciovym z zabezpieczeniem termicznym, głośność poniżej 16 dB,
- Bezprzewodowa mysz laserowa USB,
- klawiatura USB z klawiszami o niskim skoku,
- Zestaw głośników 2.1,
- Kamera z możliwością robienia zdjęć, cechująca się rozdzielczością powyżej 10 Megapikseli z systemem bezdotykowego czyszczenia matrycy, wymiennym obiektywem, elektroniczną migawką oraz możliwością wykonywania zdjęć po zdjęciu obiektywu. Filmy i zdjęcia powinny być zapisywane na karcie pamięci, która powinna mieścić co najmniej 200 zdjęć w najlepszej jakości,
- Zestaw powinien zawierać dodatkowo UPS pozwalający na podtrzymanie zasilania komputera co najmniej przez 7 minut, przy mocy wyjściowej co najmniej 750 W,
- Zestaw powinien zawierać wszelkie kable do podłączenia urządzeń peryferyjnych, przewody zasilające oraz 4 przejściówki USB-RS232.
- Z komputerem powinny zostać dostarczone sterowniki, system operacyjny Windows (64-bitowy, wersja polska), oraz pakiet biurowy Microsoft Office w aktualnej polskiej wersji,
- Listwa zasilająca na 5 gniazd,
- Gwarancja co najmniej 2 lata.

N. Kolorowa drukarka laserowa ze skanerem

- o Format druku A4,
- o Interfejs USB 2.0 i port Ethernet 10/100Base - TX ze złączem RJ45,
- o Szybkość druku (mono): 12 str./min.; (kolor): 8 str./min lub szybsze,
- o maks. szybkość druku mono: 20 str./min.
- o maks. szybkość druku kolor: 20 str./min.
- o Rozdzielczość (mono): 1200 x 600 dpi lub wyższa,
- o Rozdzielczość (kolor): 1200 x 600 dpi lub wyższa,
- o Zintegrowany skaner,
- o Pojemność pojemnika na papier: co najmniej 250 kartek,
- o Przewód USB,
- o Gwarancja co najmniej 2 lata.

O. Szafa specjalistyczna (laboratoryjna) (4 szt.)

- o Wymiary 120x50x190 cm (szerokość x głębokość x wysokość) lub zbliżone,
- o Odległość pomiędzy półkami 34 cm (± 1 cm),
- o Nie przeszklone,
- o Kolor: ciemny grafit matowy,
- o Zamykana na klucz,
- o Gwarancja co najmniej 2 lata.

P. Stolik specjalistyczny do wstępnego montażu urządzeń optomechanicznych i optycznych oraz czyszczenia urządzeń optycznych (2 szt.)

- o Wymiary 100x50x90 cm (szerokość x głębokość x wysokość) lub zbliżone,
- o Materiał: stół stalowy,
- o Na kółkach,
- o Kolor: ciemny grafit lub czarny.
- o Gwarancja co najmniej 2 lata.

Q. Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń w zakresie

W skład Pracowni Optycznych Metod Przetwarzania Informacji w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Przyrodniczo-Technicznej wchodzić będą dwa pomieszczenia:

- pomieszczenie laboratoryjne (2/B1/U224),
- pomieszczenie sterownicze (2/B1/U225).

W załączeniu 2 plany z zaznaczonymi przybliżonymi lokalizacjami przeróbek.

- o Instalacja energetyczna

Pomieszczenie laboratoryjne:

- Instalacja sieciowa (2xRJ45+3x230V Data (1,5 kW)): **4** zestawy (1),
- gniazdko DATA 230 V: **32** szt. po 1,5 kW na gniazdko (2),
- gniazdko 230 V: **24** szt. po 1,5 kW na gniazdko (3),
- gniazdko 380V (5 kW) (4),
- 2 gniazda o napięciu 230 V, jedna faza 50 Hz (gruba wtyczka jednofazowa na gruby kabel), pobór prądu 25A (6 kW), z osobnym bezpiecznikiem (5),
- Instalacja elektryczna przygotowana do zasilania rolet okiennych (łącznie **6** rolet po 100W) (6).

Pomieszczenie sterownicze:

- Instalacja sieciowa (2xRJ45 + 3x230V Data (1,5 kW)): **5** zestawów (1),
- gniazdko DATA 230 V: **8** szt. po 1,5 kW na gniazdko (2),
- gniazdko 230V: **18** szt. po 1,5 kW na gniazdko (3),
- gniazdko 380V (5 kW) (4).
- gniazdko napięcie 230 V, jedna faza 50Hz (gruba wtyczka jednofazowa na gruby kabel), pobór prądu 25A (6 kW), z osobnym bezpiecznikiem (5),

- o Instalacja wodna

Pomieszczenie laboratoryjne:

- 2 x zawór z wodą zimną (P) umożliwiający podłączenie węża 3/4". Podłączenie powinno gwarantować przepływ wody 4 lit/min + dedykowany odpływ (Q) umożliwiający podłączenie węża o takiej samej średnicy (do chłodzenia lasera).
- 1 x umywalka z ciepłą i zimną wodą: 1 szt.

Pomieszczenie sterownicze:

1 × zawór z wodą zimną (P) umożliwiający podłączenie węża 3/4". Podłączenie powinno gwarantować przepływ wody 4 lit/min + dedykowany odpływ (D) umożliwiający podłączenie węża o takiej samej średnicy (chłodzenie lasera).

- 1 × umywalka z ciepłą i zimną wodą: 1 szt.
- Połączenie pozwalające na przesłanie wody do chłodzenia lasera z pomieszczenia sterowniczego do pomieszczenia laboratoryjnego i z powrotem zakończone zaworami (W).

○ Wentylacja

Pomieszczenie laboratoryjne:

- Klimatyzacja działająca w obiegu zamkniętym umożliwiająca stabilizację temperatury na poziomie $\pm 1^{\circ}\text{C}$ w zakresie od 18 do 26 $^{\circ}\text{C}$,
- Filtr wychytujący większe drobiny kurzu na kratkach wlotowych wentylacji w pomieszczeniu oraz możliwość całkowitego odcięcia wentylacji.

○ Inne

- Instalacja pozwalająca na przesłanie sprężonego powietrza z pomieszczenia sterowniczego do każdego ze stołów znajdujących się w pomieszczeniu laboratoryjnym. Zawór (S) znajdujący się w pomieszczeniu laboratoryjnym powinien pozwalać na przesłanie powietrza do każdego ze stołów osobno, obu jednocześnie oraz na odcięcie dopływu powietrza. Zawory w pomieszczeniu laboratoryjnym (S) powinny pozwalać na podłączenie rurki plastikowej o średnicy wewnętrznej około 5 mm. Cała instalacja powinna być wykonana z materiałów nieelastycznych.
- Instalacja telefoniczna zarówno w pomieszczeniu sterowniczym jak i laboratoryjnym.
- Rolety na wszystkich oknach pomieszczenia laboratoryjnego umożliwiające DOKŁADNE zaciemnienie pomieszczenia. Rolety w jasnym odcieniu beżu o porowatej, rozpraszającej światło strukturze.
- Kolor ścian w pomieszczeniu laboratorium – szary matowy.
- Drzwi bezpośrednio łączące obydwa pomieszczenia.
- Podwieszona na wysokości około 2,1 m nad podłogą (lub ukryta w podłodze) konstrukcja pozwalająca na przeprowadzenie przewodów sterujących, przez odpowiedni otwór w ścianie oddzielającej obydwa pomieszczenia. Konstrukcję na planie pomieszczenia oznaczono podwójną zieloną linią.

Dokumentację projektową Wykonawca zobowiązuje się opracowana zgodnie z warunkami programu funkcjonalno-użytkowego, obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przez programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Dokumentacja projektowa zostanie dostarczona Zamawiającemu w 4 egzemplarzach (również w wersji elektronicznej na nośniku CD). Na żądanie zamawiającego, Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze dokumentacji lub jej części za dodatkowym wynagrodzeniem równym wysokości kosztu powielenia tych egzemplarzy.

Projekty wykonawcze muszą zostać uzgodnione i autoryzowane przez głównego projektanta – Studio EL Pracownia Projektowo Realizacyjna, al. Wiśniowa 23, 53-137 Wrocław, własnym staraniem i na własny koszt Wykonawcy.

Wykonawca udzieli pięciu lat gwarancji na roboty budowlane w obszarze prowadzonych prac oraz uzyska zapewnienie, iż Generalny Wykonawca obiektu podtrzymuje gwarancję na roboty budowlane całości Obiektu.

Uwagi dodatkowe dotyczące obu zestawów aparatury

- Wysokość powierzchni roboczych wszystkich stołów optycznych powinna być taka sama,
- Częściowa realizacja: nie,
- Wszystkie urządzenia optomechaniczne wykonane ze stali pozbawionej efektu rozszerzalności termicznej,
- Pomieszczenia laboratorium znajdują się na drugim piętrze,
- Dokumentacja budowlana dostępna na ul. St. Pigoń 8, 35-959 Rzeszów, Telefon: 17-872-14-77.

Zał. nr 1 do opisu części nr 1 - 2.B1.U225-plan instalacji

Zał. nr 2 do opisu części nr 1 - 4.2.B1.U225-wycinek ściany

CZĘŚĆ 2: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenie Pracowni 8.5. Technologii LLL (Lifelong Learning).

Poz.	Aparatura i wyposażenie	Ilość [szt.]
1	<p>Instalacyjny projektor multimedialny z uchwytem sufitowym o parametrach nie gorszych niż: technologia: 3 LCD, jasność: 2200 ANSI lumen, rozdzielczość: HD 1080p (1920 x 1080), kontrast: 40000 :1, żywotność lampy: 5000 godz. wielkość ekranu: od 30 cali do 300 cali, Obsługa NTSC/PAL/SEZAM, Wejście HDMI, Wejście (component) 3*RCA Cinch, Wejście D-Sub 15pin, Wejście Composite video RCA Cinch, Wejście audio RCA Cinch, Gniazdo RS-232, Gniazdo USB.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>	1
2	<p>Kompletny terminal wideokonferencyjny dla standardowych sal konferencyjnych zamontowany na mobilnym stojaku zapewniający wizualną komunikację w dowolnej sali konferencyjnej z monitorem LED full HD 55 cali, możliwością wyświetlania obrazu 3D i możliwością konwersji 2D do 3D z kompletem okularów do oglądania obrazu 3D, kodekiem, klawiaturą telefoniczną, mikrofonem, macierzowym, wymaganymi przewodami, pilotem zdalnego sterowania, aktywacją wyjścia dla drugiego monitora. Posiadający wbudowaną funkcję połączeń wielopunktowych i udostępniania treści PC użytkownikom tego systemu, pracę na danych takich jak: wykresy plany projektów i prezentacje multimedialne w jakości HD.</p> <p>Inne parametry nie gorsze niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - standardy i protokoły wideo H.264, H.263++, H261, H263 i H264 – maskowanie błędów; - rozdzielczość w trybie People: 720p, 30 klatek/s przy prędkości 832 Kb/s – 2Mb/s (7002); 4SIF (704 x 480)/4CIF (704 x 576) przy prędkości 256 Kb/s – 2 Mb/s; SIF (352 x 240), CIF (352 x 288); QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144); - rozdzielczość wideo dla treści: do 720p (7002), wejście SXGA (1280 x 1024), XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480); Wyjście: XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600); - kamera: przetwornik CCD 1280 x 720p; 12-krotny zoom optyczny; kąt widzenia 72 stopnie przy minimalnym zbliżeniu; zakres ruchu w poziomie +/- 100 stopni; zakres ruchu w pionie +20/-30 stopni; formaty wyjściowe: SMPTE 296M 1280 x 720p, 50/60 klatek/s; - standardy i protokoły audio: StereoSurround; pasmo 7 kHz z G.722, G.729A; automatyczna kontrola wzmocnienia; automatyczne wyciszenie zakłóceń; redukcja odgłosów klawiatury; tryb Live Music; automatyczne usuwanie echa; maskowanie błędów dźwięku; - sieć: iPrioryt™ dla QoS; interfejsy 2-portowy, automatyczny przełącznik NIC 10/100, złącznik RJ45; H.323 do 4Mb/s; Lost Packed Recovery™ (LPR™), możliwość konfiguracji pakietów IP (MTU); RS232 - sterowanie kamerą, przesyłanie danych, sterowanie mikserem audio; SIP do 2 Mb/s, - interfejs użytkownika: usługi katalogowe; zarządzanie systemem oparte na sieci Web; SNOP; polska wersja językowa; aktualizacja oprogramowania przez port USB - zabezpieczenia: Secure Web; uwierzytelnianie hasłem, tryb zabezpieczeń; - dokumentacja techniczna w języku polskim <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p> <p>Przeszkolenie w zakresie obsługi i użytkowania systemu.</p> <p>Wymagane jest, aby zestaw był kompatybilny z innymi zestawami już</p>	1

	występującymi na Uniwersytecie Rzeszowskim – zestawy firmy POLYCOM	
3	<p>Projektor multimedialny przenośny o parametrach nie gorszych niż: typ matrycy 3LCD, jasność: 2800 ANSI lumen, współczynnik kontrastu: 3000 : 1, waga do 3,5 kg, żywotność lampy 4000 godz., wielkość ekranu od 33 do 300 cali, torba podróżna, kabel podłączeniowy do komputera.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>	1
4	Szafa dzielona, w dwóch trzecich przeszklona od góry – osobno otwierane drzwi górnej i dolnej części zamykane zamkami, zamknięte półki, odległość między półkami na wysokość segregatorów. Wymiar (W x Sz x G): od 1900 do 2000 x od 800 do 900 x od 400 do 500	2
5	Szafka na sprzęt audiowizualny, z szufladami u dołu do ½ wysokości zabezpieczonymi zamkami, u góry z półkami o wymiarach (W x Sz x G): od 750 do 800 x od 700 do 800 x od 400 do 500, w kolorze pozostałych mebli (szaf).	1
6	<p>Interaktywny system odpowiedzi pracujący w różnych formatach i współpracujący z dowolną tablicą interaktywną, posiadający bazę pytań i możliwością wprowadzania nowych pytań, umożliwiający wyświetlanie różnych typów pytań (np. prawda/fałsz, alfanumeryczne itp.), umożliwiający integrację z programem PowerPoint, oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows, zawierający gry interaktywne, wyposażony w 35 nadajników z możliwością rozbudowy o następne nadajniki, możliwością wyświetlania raportów w postaci wykresów, kół danych statystycznych itp..</p> <p>Z polską instrukcją obsługi i polskim menu oraz kursem obsługi i wykorzystania tego systemu.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>	1
7	<p>Tablica interaktywna 94" w komplecie z uchwytem ściennym, technologia: rezystencyjna i oprogramowaniem umożliwiającym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie i zapisanie lekcji w oprogramowaniu Notebook™: • Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów, notatki oraz zapis obrazu • Definiowanie łączności dla obiektów • Zmiana obiektów na przezroczyste • Wstawianie wzorców tła i obrazów z Galerii • Przeciąganie obiektów między stronami oraz z innych aplikacji • Dołączanie plików • Zapisywanie plików w różnych formatach (np. PDF, HTML) • Zapisywanie stron jako oddzielnych plików graficznych (np. JPG, PNG, GIF) • Obsługa plików z różnych platform (np. systemów operacyjnych Windows®, Mac OS) • Przesuwanie pasków narzędzi na dół ekranu • Wstawianie plików Macromedia® FLash® z Galerii oraz dodawania własnych plików Flash • Wybór narzędzi do rysowania łączników, linii przerywanych, rodzajów pędzla itp. • Konwersja pisma ręcznego na tekst • Ujawnianie informacji za pomocą Screen Shade lub Spotlight • Pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie • Sterowanie bezprzewodowym laptopem z interaktywnej tablicy • Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo plus dźwięk z mikrofonu 	1

	<ul style="list-style-type: none"> • Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej • Wpisywanie i zachowywanie uwag w pamięci w innych aplikacjach • Zapisywanie slajdów Microsoft® PowerPoint®, plików Word i Excel oraz zapisywanie notatek w takich plikach. • Zapisywanie i zachowywanie do oprogramowania Point, CorelDRAW® oraz AutoCAD® oraz aplikacji konferencyjnych, takich jak oprogramowanie SMART Bridgit • Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim <p>Parametrach nie gorszych niż:</p> <p>Rozdzielczość sprzętowa: 4096x4096 Zasilanie tablicy: USB Tryby pracy: interaktywny, PC Whiteboard Montaż na ścianie: tak Oprogramowanie: zlokalizowane Certyfikaty: CE, RoHS, WEEE Systemy: Windows, Linux, MAC Kurs obsługi i możliwości wykorzystania tej tablicy.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>	
8	<p>Wizualizer wyświetlający obraz w maksymalnej rozdzielczości FullHD (1080p). o parametrach nie niższych niż: Rozdzielczość wyjściowa wizualizera [piksele]: UXGA (1600x1024); Matryca wizualizera [piksele]: 3000000; Odświeżanie [kl/s]: 30 FPS, Obszar skanowania [cm]: 45,7 x 34,3; Zoom optyczny wizualizera: x20; Czytnik kart pamięci; Funkcja obsługi myszy; Wbudowane oświetlenie dolne; Wbudowane oświetlenie górne; Wyjścia: VGA (D-SUB15)x2, Audio (3.5 mm stereo mini jack), Slot kart pamięci (USB), HDMI; Wejścia : VGA (D-SUB15) x2, Audio (3.5 mm stereo mini jack), Kensington Lock, Composite Video, S-Video;</p> <p>Z akcesoriami: Zasilacz, Przewody VGA, USB, Composite-Video, audio, pilot, instrukcja obsługi, oprogramowanie.</p> <p>Z polską instrukcją obsługi i polskim lub angielskim menu oraz kursem obsługi i wykorzystania tego systemu.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>	1
9	<p>Mikrofon przewodowy o parametrach nie gorszych niż: dynamiczny mikrofon wokalny, neodymowy magnes, Pasma przenoszenia: 50 do 16000 Hz, wtykiem typu mały jack kompatybilnym z gniazdami stosowanymi w komputerowych kartach dźwiękowych w zestawie ze statywem stołowym z uchwytem mikrofonowym.</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>	1
10	<p>Zestaw fotograficzny składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aparatu cyfrowego lustrzanka ze standardowym wyposażeniem o parametrach nie gorszych niż: Matryca CMOS formatu FX (pełnoklatkowa) o rozdzielczości 36,3 mln pikseli, czułość ISO 100–6400 z możliwością zwiększenia do odpowiednika ISO 25 600 oraz zmniejszenia do odpowiednika ISO 50, 4 kl./s w trybie zdjęć seryjnych z kadrowaniem w formacie FX/5:4, 5 kl./s w trybach kadrowania w formacie 1,2x/DX; 	1

<p>format plików NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy z kompresją bezstratną, stratną lub format TIFF (RGB) bez kompresji. JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG; ustawienia dla opcji kompresji: fine (około 1: 4), normal (około 1: 8) i basic (około 1: 16) (Priorytet wielkości); dostępna opcja kompresji Optymalna jakość NEF (RAW)+JPEG: pojedyncze zdjęcia zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPG; nośniki pamięci: karty pamięci SD oraz zgodne ze standardem UHS-I karty SDHC i SDXC; karty pamięci CompactFlash typu I (zgodne ze standardem UDMA); pokrycie ekranu FX (36 x 24): około 100% w poziomie i 100% w pionie 1,2 (30 x 20): około 97% w pionie i około 97% w poziomie DX (24 x 16) około 97% w poziomie i 97% w pionie 5:4 (30 x 24): około 97% w poziomie i 100% w pionie; lustro szybkopowrotne; typ migawki sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu szczeliny w płaszczyźnie ostrości; czasy otwarcia migawki: od 1/8000 do 30 s w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV, czas B (bulb), X250; czas synchronizacji z błyskiem X = 1/250 s; możliwa synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/320 s lub dłuższego; samowyzwalacz 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 ekspozycji z interwałem 0,5, 1, 2 lub 3 s; rozmiar klatki (w pikselach) oraz liczba klatek na sekundę (filmowanie) 1920 x 1080, 30 kl./s (progresywnie), 25 kl./s, 24 kl./s 1280 x 720, 60 kl./s, 50 kl./s, 30 kl./s, 25 kl./s; rzeczywista szybkość dla 60, 50, 30 i 25 kl./s wynosi 59,94, 50, 29,97, 25 i 23,976; opcje powinny obsługiwać zarówno wysoką jak i normalną jakość obrazu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dedykowanego do niego teleobiektywu formatu DX z 16,7-krotnym zoomem, ogniskowa od 18 do 300 mm (odpowiednik dla formatu FX/35 mm: 27–450 mm) w zestawie z filtrem UV. - dedykowanego do niego obiektywu szerokokątnego ze standardowym wyposażeniem tej samej firmy co aparat o parametrach nie niższych niż: długość ogniskowej 10-24 mm w zestawie z filtrem UV; - dedykowanego do niego obiektywu standardowego ze standardowym wyposażeniem tej samej firmy co aparat o parametrach nie niższych niż: długość ogniskowej 18-105 mm w zestawie z filtrem UV; - dedykowanego do niego obiektywu do makrofotografii ze standardowym wyposażeniem o ogniskowej 40 mm w zestawie z filtrem; - dedykowanej zewnętrznej lampy błyskowej ze standardowym wyposażeniem tej samej firmy, co aparat o parametrach nie gorszych niż: zakres automatycznego zoomu 17–200 mm: w czasie od 1 do 1,5 sekundy i rozszerzenia zakresu zoomu do kąta widzenia obiektywu 14 mm podczas korzystania z wbudowanego dyfuzora lub nasadki na lampę błyskową, automatyczne wykrywanie formatu przetwornika obrazowego FX lub DX, liczba przewodnia 34 (ISO 100, m), 48 (ISO 200, m), zasięg 0,6–20 m (w zależności od ustawienia obszaru zdjęcia, rozkładu oświetlenia, czułości ISO, pozycji zoomu i przysłony obiektywu), obrotowa głowica lampy w zakresach od -7° w dół lub o 90° w górę z sygnalizacją zaskoczenia (kliknięciem) przy ustawieniach -7°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90°, w poziomie o 180° w lewo i w prawo z sygnalizacją zaskoczenia; - dedykowanego do aparatu zestawu lamp do makrofotografii ze standardowym wyposażeniem z kontrolerem umożliwiającym sterowanie bezprzewodowe, w zestawie z pierścieniami adaptującymi wkręcany w gwint o średnicy 52/62/67/72/77mm; - dedykowanego dodatkowego akumulatora jonowo-litowego tej samej firmy, co aparat o pojemności nie mniejszej niż 1900 mAh; - dwie karty pamięci dedykowanej do aparatu o szybkości zapisu nie mniejszej niż 	
--	--

	<p>standard Ultra II i 32GB pojemności;</p> <ul style="list-style-type: none"> - torby transportowej mieszczącej aparat i podstawowe akcesoria; - statywu z uchwytem mocującym dopasowanym do aparatu o parametrach nie gorszych niż: maksymalna wysokość: od 30 do 170 cm, liczba modułów nóg 3, kulowa głowica: wymienna, liczba stopni swobody: 3; zdejmowana płyta mocująca aparat, maksymalne obciążenie ok. 3,5 kg i pokrowcem <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>	
11	<p>Kamera cyfrowa ze standardowym wyposażeniem, nie gorsza niż: trójprzetwornikowa 3MOS, zapisem Full HD 1920 x 1080 pikseli, 50 kl./s, optyczną stabilizacją obrazu, nagrywaniem obrazu 2D i opcjonalnego nagrywania obrazu 3D, całkowitą liczbą pikseli ok. 9 megapiksela, Zoom optyczny x12, wbudowany twardy dysk 200-250 GB, gniazdem kart pamięci SD, SDHC, SDXC, charakterystyką obiektywu: światłosiła: ok. F1,5(W) - ok. F2,8(T), ogniskowa 35,0 700 mm, szybkość migawki 1/25 – 1/8000 sek; tryb nocny; minimalne oświetlenie od 1 do 2 luxa; regulacja ostrości automatyczna i ręczna; wyjście HDMI; port USB 2.0; gniazdo S-Video; wbudowana lampa błyskowa; wbudowana lampa video; system zapisu dźwięku Dolby Digital 5.1; menu w języku polskim; ze standardowym wyposażeniem: przewody, akumulator, instrukcja obsługi itp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatkowy akumulator tej samej firmy, co kamera, nie gorszy niż 1250mAh, - obiektywem konwersyjnym 3D, - torba transportowa na kamerę. <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>	1
12	<p>Tablica samokopiująca o obszarze kopiowania obszar kopiowania: 1250 x 850 mm, w komplecie ze stojakiem do ustawienia na podłodze</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>	1
13	<p>Tablica bezpyłowa biała o wymiarach 1700x1020</p>	1
14	<p>Zestaw wideo jednego producenta, w skład, którego wchodzi:</p> <p>Telewizor LED o parametrach nie gorszych niż: przekątna obrazu 32" FULL HD 3D z możliwością konwersji obrazu 2D do 3D, kompletem okularów składającym się z co najmniej 4 szt. do oglądania obrazu 3D; standardzie rozdzielczości HD Ready 1080p (Full HD); rozdzielczości nominalnej (w pikselach) 1920 x 1080; złączach RJ-45, USB, złącze D-Sub (VGA), słuchawkowe, HDMI, WiFi, Eurozłącze, cyfrowe wyjście audio, Czytnik kart SD, CI+, Wejście A/V; ilości złącz USB 3 szt., HDMI 4 szt.; funkcje USB: odtwarzanie wideo, przeglądanie fotografii, odtwarzanie muzyki, nagrywanie wideo; dodatkowe funkcje: Social TV, Skype, przeglądarka internetowa, PVR Ready, DLNA, konwersja 2D-3D, EPG</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw kina domowego z odtwarzaczem Blu-ray o parametrach nie gorszych niż: wbudowany interfejs sieci Wi-Fi oraz obsługą wideopojęczeń przez Skape; konwersją obrazu 2D-3D; możliwością odtwarzania płyt DVD-R / DVD-R DL / DVD-RW; CD, CD-R / -RW; systemem audio 5.1; złączem USB; czytnikiem kart pamięci SD - nagrywarka DVD o parametrach nie gorszych niż: wbudowany dysk twary 250 GB; odtwarzane formaty DVD-Video, DVD-RAM, DVD-RW/ -R (DL), +RW/ +R (DL), CD, MP3, JPEG oraz DivX. Umożliwia nagrywanie na dysku twardym oraz nośnikach 	1

	<p>DVD-RAM/ -RW/ -R (DL), +RW/ +R (DL); odtwarzane płyty: DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-Video CD-R CD-RW SVCD VCD JPEG MP3 DivX; rodzaje nagrywanych płyt: DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD-RAM DVD+R DVD+RW DVD+R DL; tryby nagrywania: XP SP LP EP; systemy wideo: System video SECAM (tylko wejście) / system koloru PAL: 625 linii; 50 pól/ system koloru NTSC: 525 linii; 60 pól System nagrywania MPEG2 (hybrydowy VBR) Konwersja do formatu 1080p Automatyczny wybór napędu; złącza HDMI, Component Video, Karta pamięci SD, USB;</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>	
15	<p>Pakiet graficzny w polskiej wersji językowej zawierający narzędzia: edytor ilustracji wektorowych i oprogramowanie DTP; aplikację do edycji obrazu, przekształcenia map bitowych na postać wektorową, oprogramowanie do tworzenia stron internetowych, narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu, natychmiastową wyszukiwarkę treści, interaktywne narzędzie do pracy grupowej.</p> <p>Ponadto posiadający w pakiecie i ułatwiający projektowanie złożonych grafik przykładowe wysokiej jakości obrazy clipart i obrazy cyfrowe, wysokiej rozdzielczości zdjęcia cyfrowe, profesjonalne szablony, szablony pojazdów, ramki itp.</p> <p>Przykładowym pakietem graficznym spełniającym wymagania jest CorelDraw X6</p>	18
16	<p>Pakiet oprogramowania multimedialnego w polskiej wersji językowej oferujący zaawansowane funkcje odtwarzania oraz edycji plików wideo, oprogramowanie umożliwiające nagrywanie oraz tworzenie kopii zapasowych. Przykładowe oprogramowanie spełniające wymagania to NERO 10</p>	18
17	<p>Oprogramowanie stanowiące kompletne narzędzie do produkcji filmów wideo. Umożliwiające zapisywanie materiału na wybranym dysku lub przygotowanie wysokiej jakości materiałów DVD oraz Blu-ray wraz z menu. Oprogramowanie powinno występować w polskiej wersji językowej, z polską instrukcją oraz kursem z zakresu obsługi i wykorzystania tego oprogramowania. Przykładowe oprogramowanie spełniające wymagania to Adobe Premiere Pro CS5.</p>	8
18	<p>Skaner stacjonarny do skanowania zdjęć, slajdów, negatywów oraz tekstu (OCR); rozdzielczość 6400 dpi x Sub 9600 dpi (skanowanie z uchwytu kliszy), 4800 x 9400 dpi (skanowanie arkuszy refleksyjnych i kontaktowych); skanowane rozmiary: negatywy, A4, slajdy; głębi9a kolorów nie mniejsza niż: Wewnętrznie: 48 bit (281,5 biliona kolorów), Wyjściowo: 48 bit (281,5 biliona kolorów), 24 bity (16,7 trylion kolorów), 16 bitów (65 536 poziomów skali szarości), 8 bitów (256 poziomów skali szarości), 1 bit (tryb monochromatyczny).</p> <p>Gwarancja: min. 24 miesiące</p>	1

Wykonawca opracowuje projekt wykonawczy i wykona na jego podstawie roboty budowlane konieczne do wykonania instalacji umożliwiającej prawidłowe uruchomienie i działanie wyposażenia dla pracowni 8.5.

Należy zaprojektować i wykonać:

- instalację elektryczną potrzebną do zainstalowania projektora i tablicy interaktywnej w oparciu o wytyczne przedstawione przez Zamawiającego w pomieszczeniach B2/214 oraz B2/215, prace dotyczą również zamocowania projektora oraz tablicy interaktywnej i bezpyłowej.

Zakres prac projektowych obejmować będzie:

- projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami (również w wersji elektronicznej na nośniku CD) – 4 egz.,
- uzgodnienia dokumentacji.

Dokumentację projektową Wykonawca zobowiązuje się opracować zgodnie z warunkami programu funkcjonalno-użytkowego, obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Dokumentacja projektowa zostanie dostarczona Zamawiającemu w 4 egzemplarzach.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze dokumentacji lub jej części za dodatkowym wynagrodzeniem równym wysokości kosztu powielania tych egzemplarzy.

Projekty wykonawcze muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym.

Wykonawca udzieli pięciu lat gwarancji na roboty budowlane w obszarze prowadzonych prac oraz uzyska zapewnienie, iż Generalny wykonawca Obiektu podtrzymuje gwarancję za roboty budowlane całości Obiektu.

.....
*Sekretarz komisji
przetargowej*

**Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Eugeniusz Niżnik**

.....
*Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona*